

BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000040334_01_03
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 0000040334_01 vom 05. November 2019

Messeinrichtung: MEAC300 für Emissionsauswertung

Hersteller: SICK AG
Nimburger Straße 11
79276 Reute
Deutschland

Umweltbundesamt

Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der Überwachung der Emissionen und der Immissionen vom 31. März 2021

Veröffentlichung: BAnz AT 03.05.2021 B9

- III. Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung
von Emissionen und Immissionen:**
- 54 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes
vom 28. Juni 2019 (BAnz AT 22.07.2019 B8, Kapitel IV Nummer 1.2) und
vom 27. Mai 2020 (BAnz AT 31.07.2020 B10, Kapitel II 17. Mitteilung)**

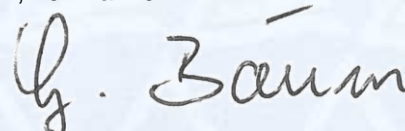
Die aktuelle Softwareversion des Emissionsauswertesystems MEAC300
der Firma SICK AG lautet:
4.1.34.25

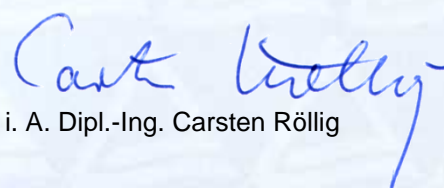
Die Versionen 4.1.34.18 bis 4.1.34.21 dürfen nicht mehr verwendet werden.
Bei diesen Versionen wird ungültigen Messwerten teilweise ein falscher Status zugewiesen.

In Anlagen mit EFÜ-Datenfernübertragung ist die neue Version einzusetzen, da in den
älteren Versionen zeitweise eine unvollständige Datenübertragung stattfindet.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 27. August 2020

TÜV Rheinland Energy GmbH
Köln, 25. Mai 2021


i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum


i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

www.umwelt-tuv.eu
tre@umwelt-tuv.eu
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.